

# Føde-/gyn-pol



**04.01.022, 04.01.034, 04.01.067, 04.01.071, 04.01.073 og 04.01.074**  
 Alle rom har samme RFP og utstyrsliste som utsendt for 04.01.022  
 (Kombistol og ultralyd)

**04.01.211:**  
 Har unik RFP og utstyrsliste  
 (CTG-rom)

**04.01.076, 04.01.077, 04.01.078, 04.01.080 og 04.01.082:**  
 Alle rom har samme RFP og utstyrsliste som utsendt for 04.01.076  
 (Kombistol, ultralyd og doppler)

**04.01.175 og 04.01.176:**  
 Begge rom har samme RFP og utstyrsliste som utsendt for 04.01.175  
 (kombistol og ultralyd)


**04.01.210:**  
 Avledet RFP og utstyrsliste fra SRMAL175.30  
 (kombistol, ultralyd, doppler, pasientovervåking og kolposkop)

**04.01.159:**  
 Avledet RFP og utstyrsliste fra SRMAL.175.31  
 (gynstol, mobil pasientløfter, ultralyd og kolposkop)

**04.01.160, 04.01.161, 04.01.062 og 04.01.064:**  
 Alle rom har samme RFP og utstyrsliste som utsendt for 04.01.160  
 (gynstol og ultralyd)

**04.01.063:**  
 Avledet RFP og utstyrsliste fra SRMAL.175.31  
 (gynstol, ultralyd, diatermiapparat og røykavsug)

# Føde

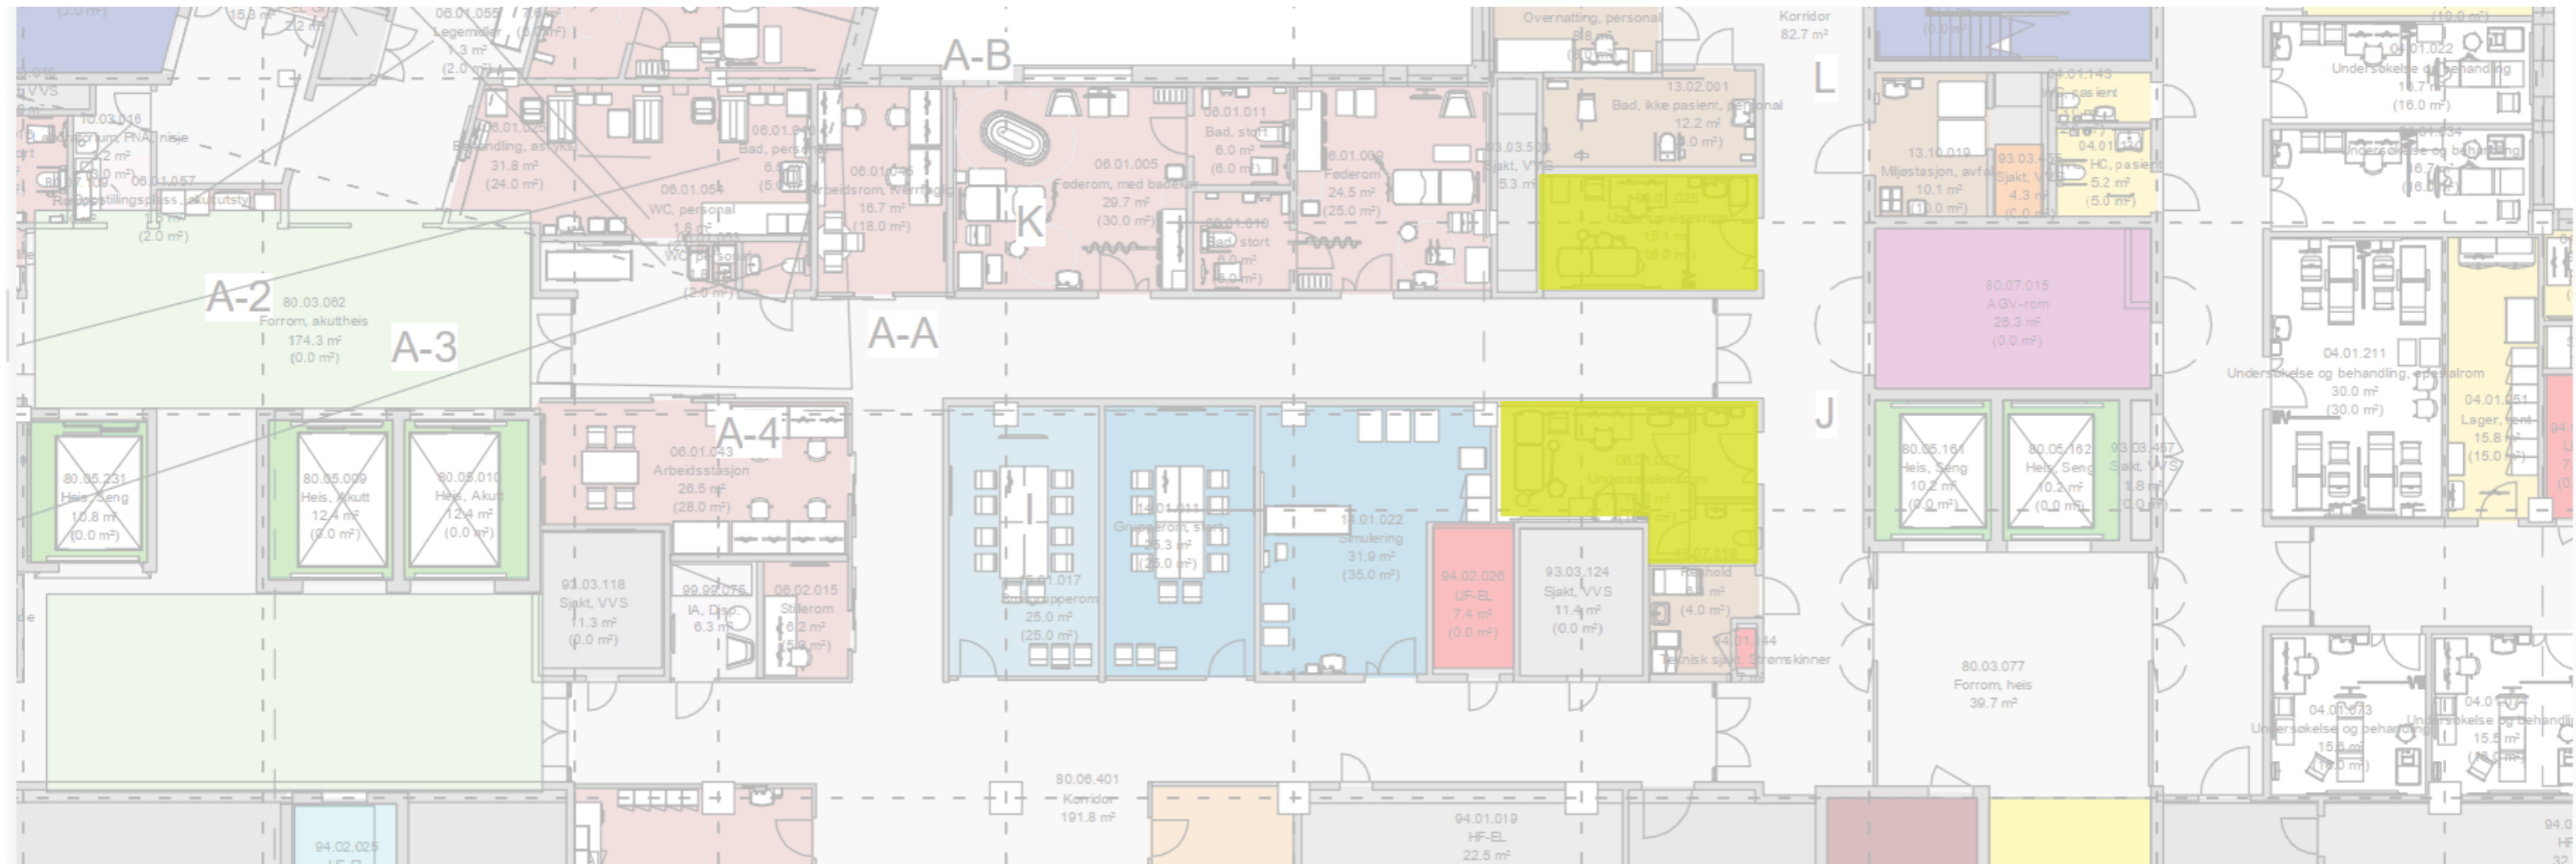

06.01.028 og 06.01.027:  
RFP og utstyrliste fra SRMAL175.01  
(kombistol og ultralyd) OBS: 06.01.027 er kontaktsmitteisolat

# Føde-/gynmottak



- 06.02.001:**  
 RFP og utstyrliste avledet fra SRMAL175.01  
 (kombistol, CTG, pasientovervåking, doppler og lystgass)
  
- 06.02.005, 06.02.006, 06.02.007 og 06.02.008:**  
 RFP og utstyrliste avledet fra SRMAL175.01  
 (kombistol, CTG og ultralyd)